


Compat® StayPut










COMPAT® STAYPUT 9/18FR 165/120 CM S

GLOBE REF 12380234

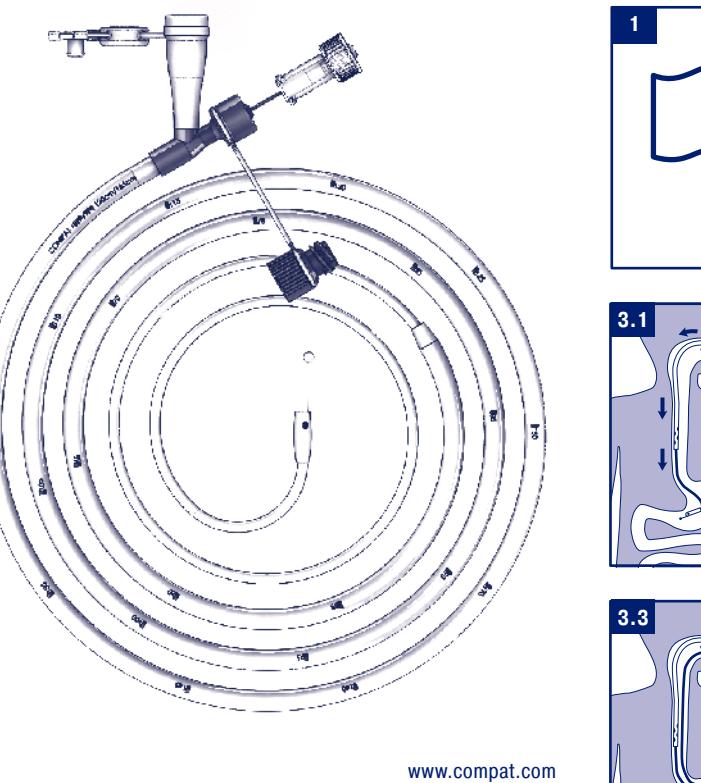

www.compat.com

second fold vertically
83,5mm

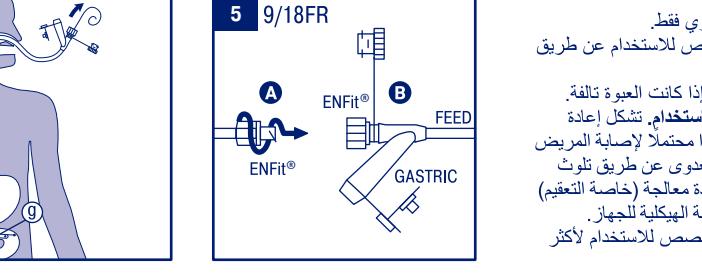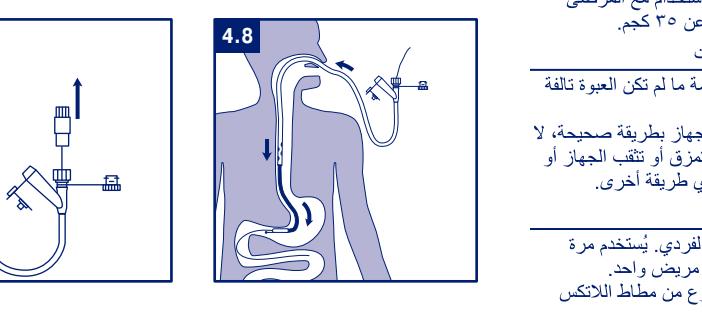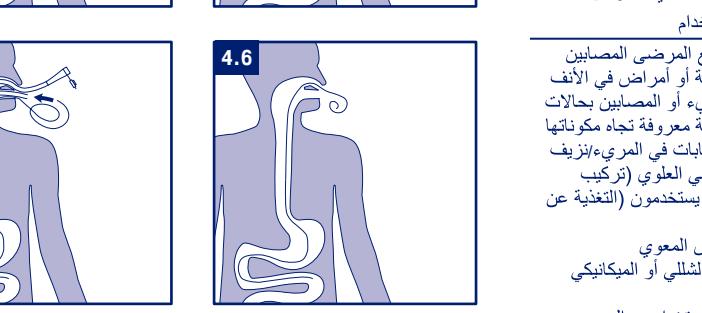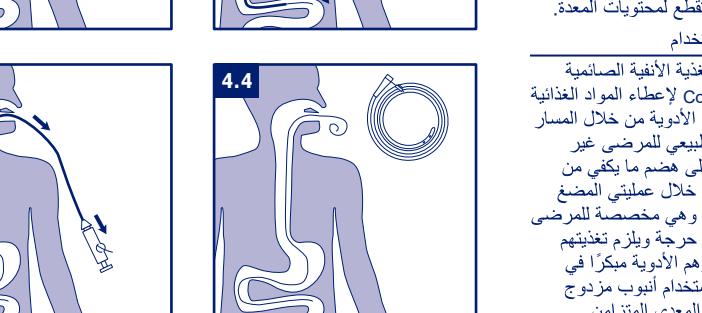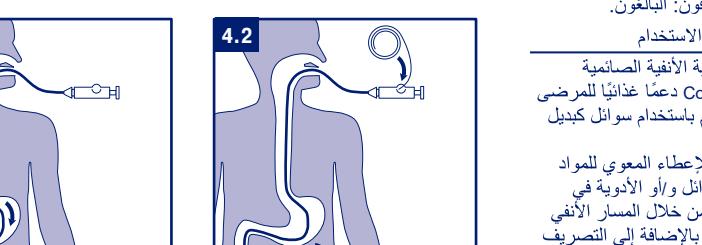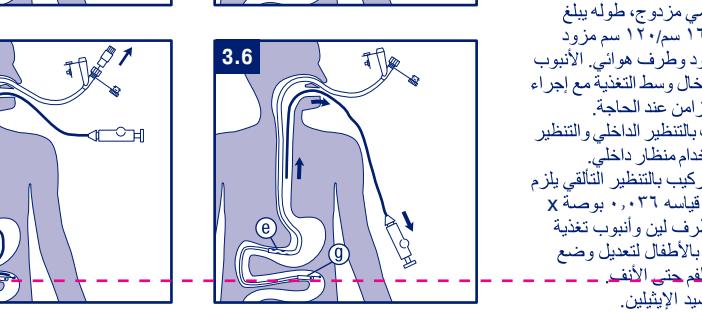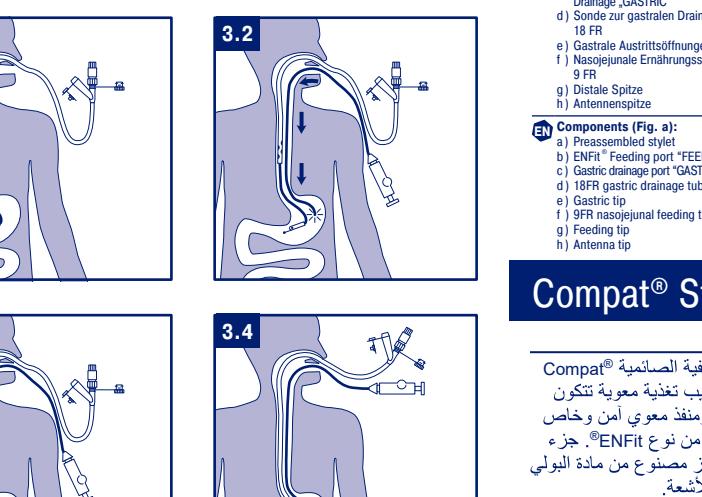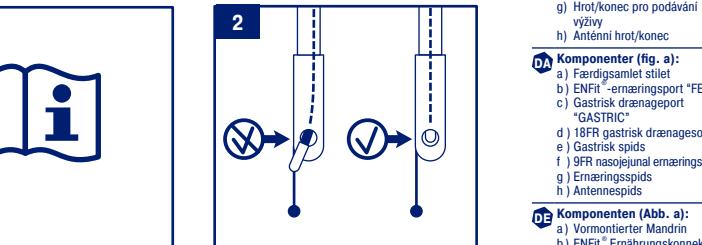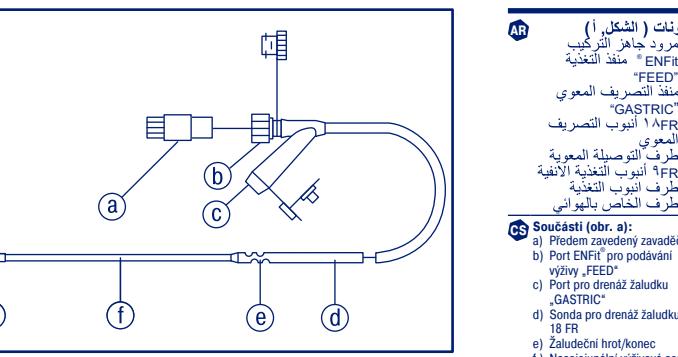

sterile

7000082
25FB2019
C01151

Cedic srl
Via Libeazione 63/9,
I-20068 Pescara Borromeo (MI)

Unless stated otherwise, all trademarks are owned by Société des Produits Nestlé S.A. or used with permission.

CE 0123

02123

7000082
25FB2019
C01151



Components (Fig. a):

a) Przewód do żywienia

b) ENFit® - "Gastric feeding"

c) Gastrostomy connector

d) Sonde de drainage gastrique

e) Gastrostomy

f) Sonde nasojelajonalna do żołądka

g) Nasojelajonalny wąż sondy

h) Antenorezor

i) Antenorezor

j) Port ENFit®

k) Port do żywienia

l) Gastrostomy port

m) Gastrostomy connector

n) Gastrostomy

Components (Fig. a):

a) Przewód do żywienia

b) ENFit® - "Gastric feeding"

c) Gastrostomy connector

d) Sonde de drainage gastrique

e) Gastrostomy

f) Sonde nasojelajonalna do żołądka

g) Nasojelajonalny wąż sondy

h) Antenorezor

i) Antenorezor

j) Port ENFit®

k) Port do żywienia

l) Gastrostomy port

m) Gastrostomy connector

n) Gastrostomy

Components (Fig. a):

a) Przewód do żywienia

b) ENFit® - "Gastric feeding"

c) Gastrostomy connector

d) Sonde de drainage gastrique

e) Gastrostomy

f) Sonde nasojelajonalna do żołądka

g) Nasojelajonalny wąż sondy

h) Antenorezor

i) Antenorezor

j) Port ENFit®

k) Port do żywienia

l) Gastrostomy port

m) Gastrostomy connector

n) Gastrostomy

Components (Fig. a):

a) Przewód do żywienia

b) ENFit® - "Gastric feeding"

c) Gastrostomy connector

d) Sonde de drainage gastrique

e) Gastrostomy

f) Sonde nasojelajonalna do żołądka

g) Nasojelajonalny wąż sondy

h) Antenorezor

i) Antenorezor

j) Port ENFit®

k) Port do żywienia

l) Gastrostomy port

m) Gastrostomy connector

n) Gastrostomy

Components (Fig. a):

a) Przewód do żywienia

b) ENFit® - "Gastric feeding"

c) Gastrostomy connector

d) Sonde de drainage gastrique

e) Gastrostomy

f) Sonde nasojelajonalna do żołądka

g) Nasojelajonalny wąż sondy

h) Antenorezor

i) Antenorezor

j) Port ENFit®

k) Port do żywienia

l) Gastrostomy port

m) Gastrostomy connector

n) Gastrostomy

انزع المرود برق قبل استخدام التبوب، ثم ثبّت تثبيت المظارع الداخلي بيته، ثم انتزح المظارع الداخلي في مكانه.
بعد إدخال التبوب في المريض، ينصح بالبقاء على سطح المريض حتى يتم إدخال التبوب في المريض.

يُنصح بـ"StayPut" لـ"Gastric feeding" وذلك في الماء.

التبوب ينبع من المريض إلى الماء.

</div

